

KONTEYNER ŞARTNAMESİ

BESİN CERRAHİ

1 Konteynırda sterilizasyon için kullanılan sistemin, valfli veya biobarierli sterilizasyon sistemi olduğu ve etkin çalıştığını gösteren Uluslararası veya Ulusal Patent Enstitüsü kurumundan üretici firma ve marka adına alınmış belgesi olmalıdır. Bu belge ihale dosyası içerisinde komisyona sunulmalıdır.

2 Sterilizasyon konteynerlerinin özellikleri aşağıda belirtilen şekilde olacaktır;
a- Konteyner filtreleri sağlıklı sterilizasyon yapılması için belirli sayıda sterilizasyondan sonra değiştirilmektedir ve ameliyathane ortamında bunun kontrolü güç olmaktadır. Ayrıca periyodik olarak konteyner filtresi tedariki de kuruma ek maliyet getirmektedir. Bunların önlenmesi için, cerrahi alet setleriyle birlikte verilecek konteynırlar valfli veya mikro barierli olmalıdır.

b- Her bir set için alınacak konteynerlerde farklı setlere ait konteynerlerin birbiri ile karışmasını önlemek amacıyla konteyner kapaklarında veya kulplarında en az 5 adet renk seçeneği olmalıdır.

c- Teklif edilen konteynerların kapakları ısıya dayanıklı polimer veya alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3 Konteynır kapak kilitleme mekanizması ve filtre tutucu gibi diğer bütün parçaları Elektro Polisaj işlemi uygulanmış 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, kilit filapıları istenilen pozisyonda sabit kalabilmeli ve 180 dereceye kadar kutu kapaklarının içine katlanabilir olmalıdır. Ayrıca konteynırlar üst üste konulabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

4 Konteynırların birleştirme parçalarının tamamı perçinli ve kapalı iken kutu dışından görünmeyecek şekilde olmalıdır. Konteynırların gövdelerinde bulunan kilit mekanizması yaylı olacaktır. Ayrıca konteynırların ömrünü uzatmak için etiket blokları tek parça olmalıdır.


5 Konteynırların kullanım amacını yerine getirdiğini ve sterilizasyon bütünlüğünü 180 gün koruyabildiğini gösteren üniversitelerin Mikrobiyoloji Kliniklerinden veya akredite kuruluşlardan alınmış test raporu ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

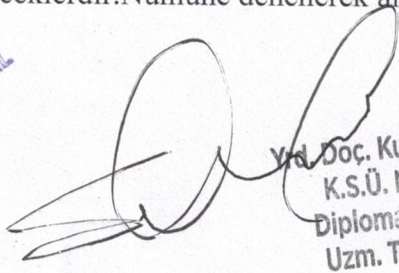
6 İhtiyaç listesinde belirtilen sepetlerin yapısı delikli düz bir yapıya sahip plak şeklinde olmalı, sepetlerin içerisinde konulacak aletlerin uç kısımlarının hassas olması, zarar görmemesi ve alet yüzeylerinin çizilmemesi için "Tel Örgü" şeklinde olmamalıdır. Sepetlerin taşıma kollarının konteynırın içerisinden çıkarılması esnasında kullanıcıya kolaylık sağlayacak düzeyde olmalı ve 3 ayrı pozisyonda tutulabilecek yapıda olmalıdır.

7 Konteynırlar için noter tasdikli TS EN 868-8 Uygunluk Belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

8 Kilit mekanizmaları aynı zamanda kapak tutamacı olarak kullanılabilirmeli, tek parçadan oluşmalı ve kapağın çabuk ve güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağlamalıdır. Kilit mekanizmasının tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

9 İhale esnasında iştirakçi firmalar, istenilen her bir ölçüden 1'er adet konteyner ve sepet getireceklerdir. Numune denenerek alımına karar verilecektir.


K. Kutsal Devrim Seçinti
Dip. No: 6505


Yrd. Doç. Kutsal Devrim Seçinti
K.S.Ü. Nöroşirürji ABD
Diploma Tescil No: 4860
Uzm. Tescil No: 120868

Y 120.15WB KONTEYNER +KAPAK 580X280X150 MM 3 ADET BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ

Y 140.15WB KONTEYNER +KAPAK 580X280X150 MM 4 ADET BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ

Y 181.10 539X252X110 MM SEPET 15 ADET BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ
Y 360.10 WB KONTEYNER +KAPAK 285X280X100MM 3 ADET BEYİN

CERRAHİ KLİNİĞİ

Y 380.07 242X252X65 MM SEPET 3 ADET BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ

Prof. Dr. M. Zafar YOUSSEF
K. A. J. Institute
Dip. No. 6505

Yrd. Doç. Dr. Davrim Secinti
K.S.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ABD
Diplom No: 4860
Uzm. İktisadi No: 120868