


ANNE DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 180x40x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Dolapta 16 adet ayrı ayrı bölmeli dolaplara sahip olmalıdır.
5. Dolap kapakları çift cidarlı ve tutamaklı olmalıdır.
6. Kapaklarda sıra numarası olmalıdır.
7. Dolap kapakları çift cidarlı ve çitçit mekanizmalı olmalıdır.
8. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
9. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
10. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
11. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
12. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
13. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
14. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
15. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
16. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

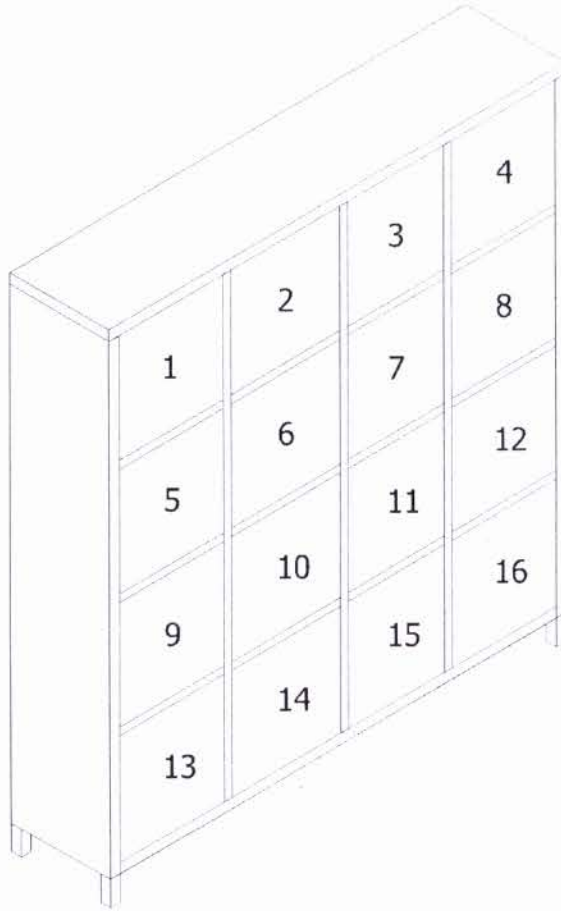


Doç. Dr. S. K. KUTLU
Uzmanlık Alanı: Çocuk Hastalıkları
K.S.U. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr. S. K. KUTLU
Yrd. Doç. Dr. S. K. KUTLU
KSÜ - Dip. Tes. No: 12000 ABD.
KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

ÇOCUK YOĞUN BAKIM DOLABI-1 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 110x55x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Ürün alt tarafında 5 sıra halinde toplam 10 adet çekmece bulunmalıdır.
5. Ürün üst tarafında çift kapaklı bir dolap bulunmalıdır.
6. Üst dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
7. Çekmece yüksekliği en az 25 cm olmalıdır.
8. Üst 2 çekmeceler demonte paslanmaz üç bölmeli olmalıdır.
9. Alt 3 sıra çekmeceler demonte paslanmaz iki bölmeli olmalıdır.
10. Çekmece kafaları çift cidarlı ve teleskopik raylı olmalıdır.
11. Çekmece ve dolap kapakları plastik demonte yapıda olmalıdır.
12. Dolap kapakları çift cidarlı ve çitçit mekanizmalı olmalıdır.
13. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

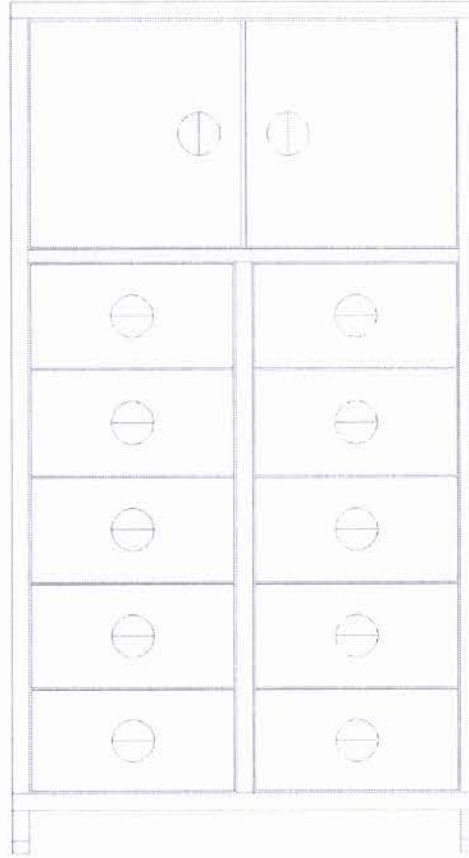


Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 80082 Yarıdanım 10512
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Döşem Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Savaş İZFK
Yrd. Dip.
K.S.U. Tıp Fakültesi

ÇOCUK YOĞUN BAKIM-2 DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 106x55x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Ürün alt tarafında 5 sıra halinde toplam 10 adet çekmece bulunmalıdır.
5. Ürün üst tarafında çift kapaklı bir dolap bulunmalıdır.
6. Üst dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
7. Çekmece yüksekliği en az alt iki sıra 30 cm ve üst 3 sıra en az 20 cm olmalıdır.
8. Üst 3 sıra çekmeceler demonte paslanmaz üç bölmeli olmalıdır.
9. Alt 2 sıra çekmeceler demonte paslanmaz iki bölmeli olmalıdır.
10. Çekmece kafaları çift cidarlı ve teleskopik raylı olmalıdır.
11. Çekmece ve dolap kapakları plastik demonte yapıda olmalıdır.
12. Dolap kapakları çift cidarlı ve çitçit mekanizmalı olmalıdır.
13. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

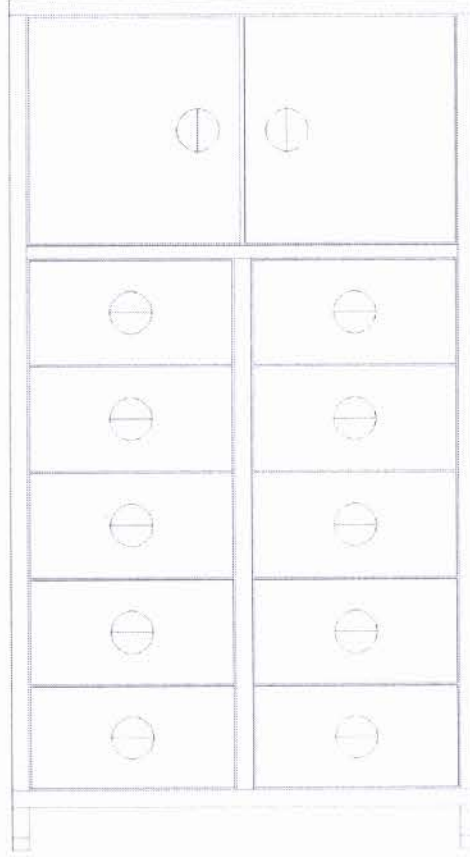

Doç. Dr. Sadık YUKTTUTAN
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 80062 Yandal M...
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeni Döner...
...
...

Yrd. Doç. Dr. Sevcin İPEK
Dip. Tes. No: 0122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

İLAÇ ODASI DOLABI-3 ADET TEKNİK ŞARTNAMESİ

17. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
18. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
19. Ürün ebadı yaklaşık 90x55x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
20. 3 adet yan yana konacak şekilde montaj edilmelidir.
21. Ürün alt tarafında 5 sıra halinde toplam 10 adet çekmece bulunmalıdır.
22. Ürün üst tarafında çift kapaklı bir dolap bulunmalıdır.
23. Üst dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
24. Çekmece yükseklikleri alt iki sıra 30 cm, orta sıra 20 cm ve üst iki sıra 15 cm olmalıdır.
25. Çekmece kafaları çift cidarlı ve teleskopik raylı olmalıdır.
26. Çekmece ve dolap kapakları plastik demonte yapıda olmalıdır.
27. Çekmece içleri aşağıda verilen şekilde bölmeli yapıda olmalıdır.
 - a. 1 âdetinin üst 3 sıra çekmecesini 2 bölmeli
 - b. 1 âdetinin üst 3 sırası çekmecesini 2 ve 8 bölmeli
 - c. 1 âdetinin üst 3 sıra çekmecesini 4 bölmeli
28. Dolap kapakları çift cidarlı ve çıkçıt mekanizmalı olmalıdır.
29. Dolap ile birlikte 200 adet etiketlik verilmelidir.
30. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
31. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
32. Evye ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
33. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
34. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
35. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
36. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
37. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
38. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
39. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
40. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.




Doç. Dr. Sadık YURTUTAN
Dipl. No: 1/1995
Uzmanlık No: 86062 Yandaş No: 10512
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Selcan İPEK
Dip. Tes. No: 22264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD

İLAÇ ODASI EVYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 190x70x85+40 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Evye üst tablası çökertmeli olmalıdır.
5. Evye ebatı en az 40x50x25 cm olmalıdır.
6. Evyede 1 adet yüksek kaliteli fotosel batarya olmalıdır.
7. Üst tabla arkası yüksek sırtlı olmalıdır.
8. Evye altında kapaklı dolap şeklinde olmalıdır.
9. Evye yanlarında 2 sıra halinde toplam 8 adet çekmece olmalıdır.
10. Çekmece içleri demonte paslanmaz 4 bölmeli olmalıdır.
11. Çekmece kafaları çift cidarlı ve en az 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
12. Çekmeceler teleskopik sistemli raylara sahip olmalıdır.
13. Çekmeceler gömme tip plastik tutamaklara sahip olmalıdır.
14. Evye üzerinde dört kapaklı dolap bölmesi olmalıdır.
15. Dolap kapakları çift cidarlı olmalıdır.
16. Dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
17. Ürünle birlikte ilgili mekana uygun peçetelik ve sabunluk verilmelidir.
18. Evye ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
19. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
20. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
21. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
22. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
23. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
24. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
25. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
26. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

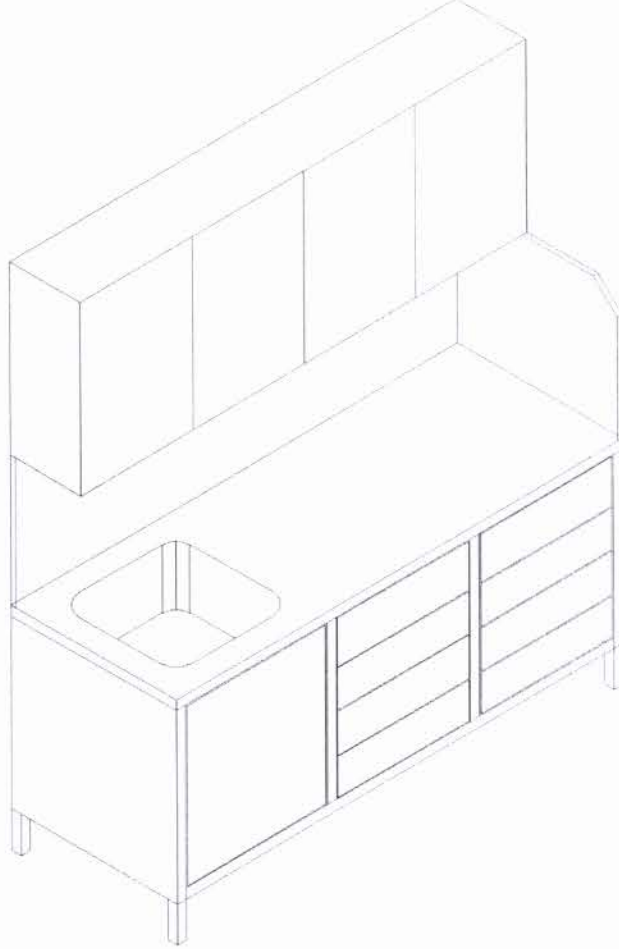


Doç. Dr. Sadık YILMAZ
Dipl. No: 17995
Uzmanlık No: 80081
K.S.Ü. Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Sadık Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Sevilan İPEK
Dip. Tes. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi, Pediyatri ABD

KAN GAZI TEZGÂHI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 100x75x85+40 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Üst tabla arkası yüksek sırtlı olmalıdır.
5. Ürün altı çekmeceli ve açık dolaplı şekilde olmalıdır.
6. Çekmece içi bölmeli olmalıdır.
7. Çekmece kafası çift cidarlı ve en az 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
8. Çekmece teleskopik sistemli raylara sahip olmalıdır.
9. Çekmece gömme tip plastik tutamaklara sahip olmalıdır.
10. Dolap altında taban raflı olmalı ve etrafı kapalı olmalıdır.
11. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
12. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
13. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
14. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
15. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
16. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

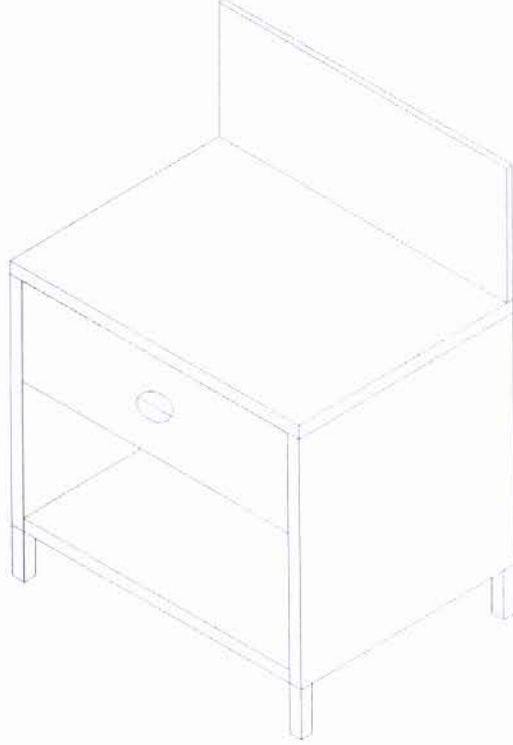


Doç. Dr. Sadi YURTTUTAN
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 80982 Yandal No: 10512
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Selcan İPEK
Dip. Tes. No: 12264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

LAVABO ALTI RAFI – 2 ADET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Raf ebadı yaklaşık 137x48 cm ve 138x55 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Raf kalınlığı ağır malzemelerin taşınması için en az 1,2 mm kalınlıkta olmalıdır.
5. Raf mevcut duvarlara çok noktadan sabitlenmelidir.
6. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
7. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
8. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
9. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
10. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
11. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
12. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
13. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

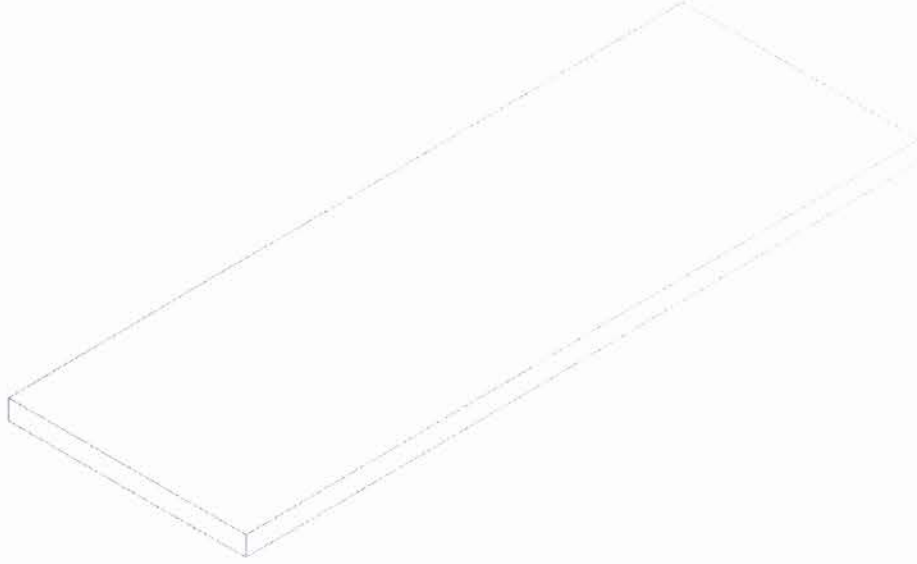


Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Dip. No: 117995
Uzmanlık No: 80002 Yandal No: 10512
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeni Döğen Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Seycan İPEK
Dip. Tes. No: 22264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

MALZEME DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 106x65x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Dolap derinliği mevcut sondalar ile uyumlu olmalı ve yüklenici bunu yerinde ölçmelidir.
5. Ürün alt tarafında 5 sıra halinde toplam 10 adet çekmece bulunmalıdır.
6. Ürün üst tarafında çift kapaklı bir dolap bulunmalıdır.
7. Üst dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
8. Çekmece yüksekliği en az alt iki sıra 30 cm ve üst 3 sıra en az 20 cm olmalıdır.
9. Alt 2 sıra çekmeceler demonte paslanmaz iki bölmeli olmalıdır.
10. Üst 3 sıra çekmeceler demonte paslanmaz üç bölmeli olmalıdır.
11. Çekmece kafaları çift cidarlı ve teleskopik raylı olmalıdır.
12. Çekmece ve dolap kapakları plastik demonte yapıda olmalıdır.
13. Dolap kapakları çift cidarlı ve çitçit mekanizmalı olmalıdır.
14. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
15. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
16. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
17. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
22. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

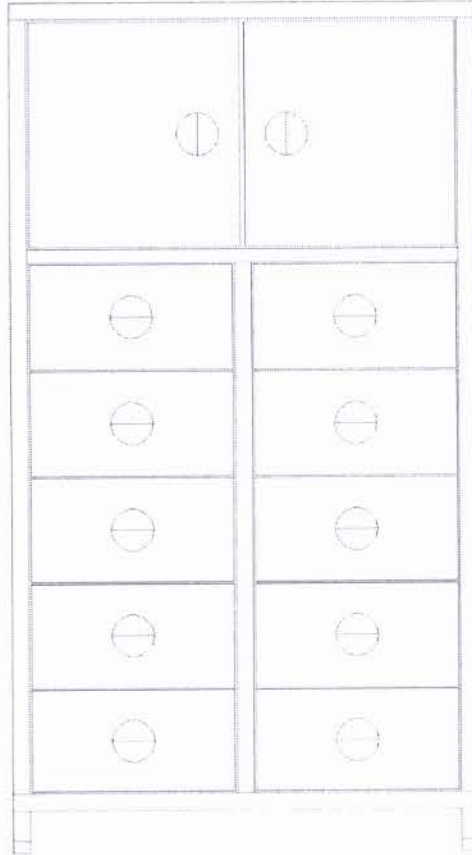


Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Dip. No: 117995
Uzmanlık No: 80002 Yandal No: 105121
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Hastanesi

Yrd. Doç. Dr. Sevgan İPEK
Dip. No: 22264
KSÜ Tıp Fakültesi Radyasyon ABD.

TEMİZLİK ODASI RAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Raf ebadı yaklaşık 180x25 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Raf ıslak malzemelerin kurutulması amaçlı tasarlanmalıdır.
5. Raf yüksekliği mevcut evye ile uyumlu olmalıdır.
6. Raf çok noktadan duvara sabitlenmelidir.
7. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
8. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
9. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
10. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
11. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
12. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
13. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
14. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

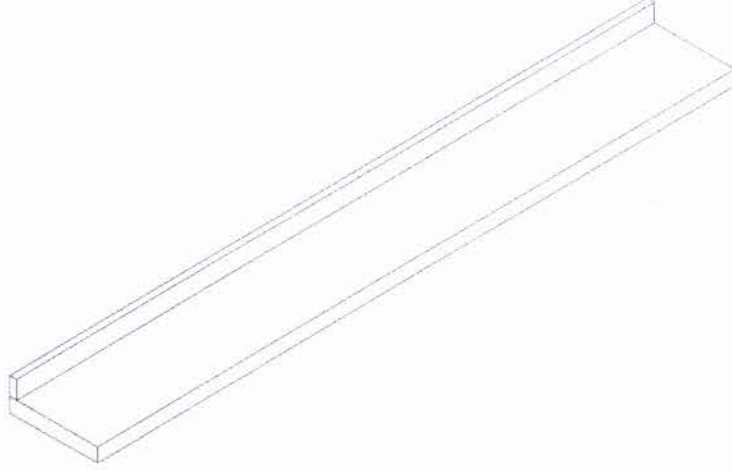


Doç. Dr. Sadık YURTUTAN
Diy. No: 17995
Uzmanlık No: 80082 Yandı No: 105121
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Sevgan İPEK
Diy. No: 122264
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

YOĞUN BAKIM EVYELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebatı yerine uygun olarak üretilmelidir.
4. 1 adet ikili evye olmalıdır. Evye ebatları yaklaşık 80-140x50x60 cm olmalıdır, üretici firma net imalat ölçülerini yerinde alıp imalata o şekilde başlamalıdır.
5. Evyede mevcut kullanılmakta olan fotoselli bataryalar yeniden kullanılacaktır.
6. Üründe gömme tip üstten basmalı iki adet sabunluk olmalıdır.
7. Sabunluk en az 1 lt kapasiteli olmalıdır.
8. Her bir evye için 1 adet paslanmaz peçetelik verilmelidir.
9. Evye ebatı en az 32 mm çapında yuvarlak tip olmalıdır.
10. Evye altında perde olmalıdır.
11. Evye üzerinde yüksek sırtlı arkalık olmalıdır.
12. Yüklenici firma mevcut ürünü yerinden sökmeli ve ürünü yerine montaj yapmalıdır.
13. Yüklenici firma hijyen açısından toz çıkartmadan çalışabilmelidir.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

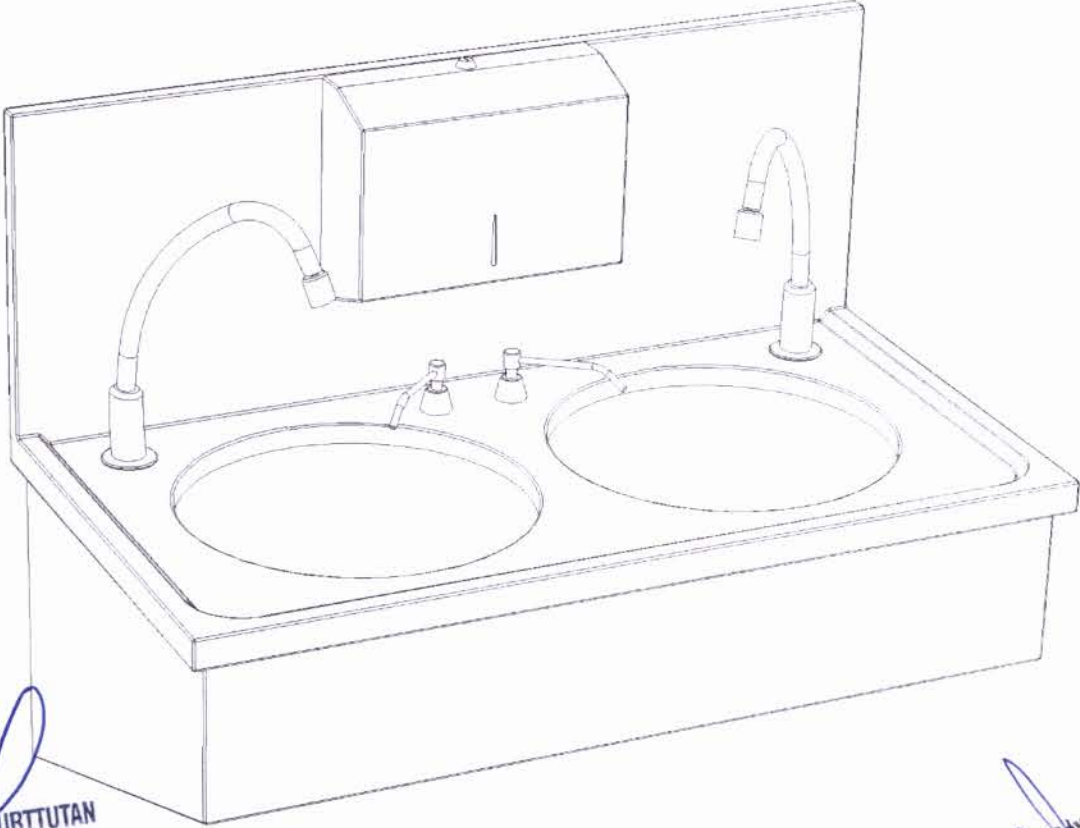


Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Dip. No: 117995
Uzmanlık No: 80002 Yandan No: 105121
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeni Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Sıvacı İPEK
Dip. Tes. No: 22264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

YOĞUN BAKIM EVYELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebatı yerine uygun olarak üretilmelidir.
4. 5 adet tekli olmalıdır. Evye ebatları yaklaşık 60-80x50x60 cm olmalıdır, üretici firma net imalat ölçülerini yerinde alıp imalata o şekilde başlamalıdır.
5. Evyede mevcut kullanılmakta olan fotoselli bataryalar yeniden kullanılacaktır.
6. Üründe gömme tip üstten basmalı sabunluk olmalıdır.
7. Sabunluk en az 1 lt kapasiteli olmalıdır.
8. Her bir evye için 1 adet paslanmaz peçetelik verilmelidir.
9. Evye ebatı en az 32 mm çapında yuvarlak tip olmalıdır.
10. Evye altında perde olmalıdır.
11. Evye üzerinde yüksek sırtlı arkalık olmalıdır.
12. Yüklenici firma mevcut ürünü yerinden sökmeli ve ürünü yerine montaj yapmalıdır.
13. Yüklenici firma hijyen açısından toz çıkartmadan çalışabilmelidir.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.

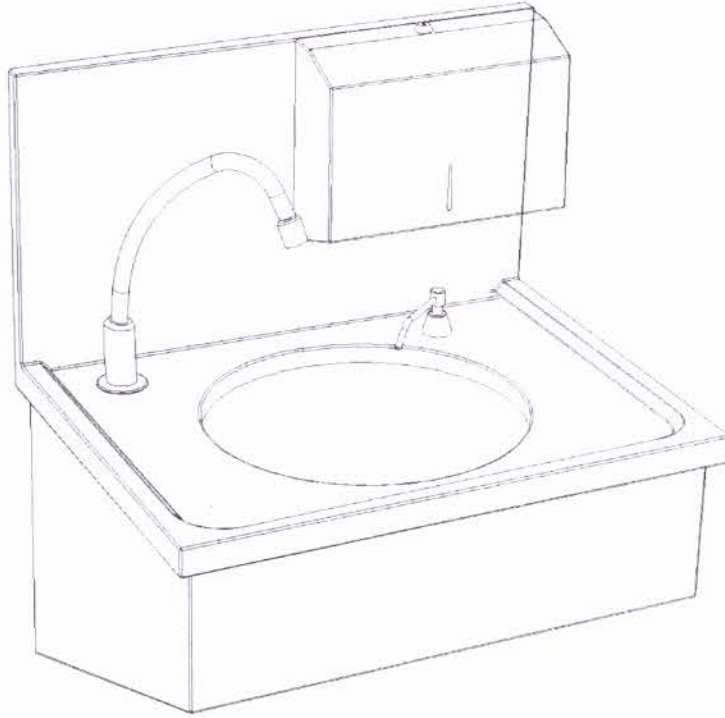

Doç. Dr. Saad YURTTUTAN
Dip. No: 117985
Uzmanlık No: 84082 Yandal No: 105123
K.S.Ü. T. Fakültesi Yeni Döğen Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Sevgan İPEK
Dip. Tes. No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.

ÇAMAŞIR SERVİS ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanılan çamaşırların toplanması için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. 3 adet, ürün ebadı yaklaşık 120x50x90 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Ürün iki bölümden oluşmalıdır.
5. İlk bölüm demonte brandalı olmalıdır.
6. Branda değiştirilebilir ve bir yedekli olmalıdır.
7. Branda etrafı tel çubuklar ile bariyerli olmalıdır.
8. Ürünün yan tarafında temiz çarşafların dizilmesi için 3 katlı servis alanı olmalıdır.
9. Servis rafları en az 60 cm uzunlukta olmalıdır.
10. Servis rafları bariyerli olmalıdır.
11. En üst raf dezenfektan vb. ürünleri koymak için şişelik bulunmalıdır.
12. Ürün iki âdeti frenli 4 tekerlekli olmalıdır.
13. Tekerlekler 100 mm çaplı olmalıdır.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.



Doç. Dr. Sadık YURTUTAN
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 80062 Y. T. 1. E. 1.
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Hastanesi

Yrd. Doç. Dr. Sevgan İPEK
Dip. Tıp No: 122264
KSÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD.