

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemelerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

1 Adet Pediatrik Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop,


- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, geniş görüş açısı ve hareketli ucu sayesinde daha iyi oryantasyon sağlamalıdır. Yukarı açısı en az 180°, aşağı açısı en az 90° olmalıdır.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, görüş yönü 0° olmalıdır.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, görüş açısı en az 90° olmalıdır.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, temizlik ve dezenfeksiyon için tamamen suya daldırılabilir ve su geçirmez olmalıdır. Katalog ile gösterilmelidir.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, EtO-Gas, Steris ve Sterrad ile sterilize edilebilir olmalıdır. Katalog ile gösterilmelidir.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, fiber optik görüntü aktarma demetinin kalitesi yüksek olmalıdır. Katalog ile gösterilmelidir.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, dayanıklı yapısı ve sağlam mekanik tasarımı sayesinde üstün kullanım ömrü sağlamalıdır. Katalog ile gösterilmelidir.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, çalışma uzunluğu 25 - 27 cm arasında olmalıdır.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, dış çapı 2,5 - 2,7 mm arasında olmalıdır.
- Teklif edilen Rino-Faringo-Laringo-Fiberskop, aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilmelidir:

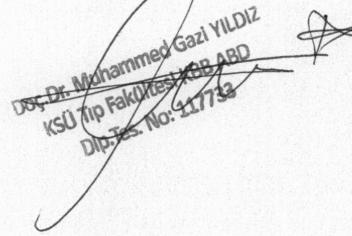
• 1 Adet Çanta

Prof. Dr. İsmail ORHAN
KSÜ Tıp Fakültesi
KBB AD.
Dip. No: 131819-02 No: 3282

Doç. Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
KSÜ Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip. No: 117/83

- 1 Adet Basınç Kompanse Başlığı
- 1 Adet Kaçak Test Cihazı, puar ve manometresi ile birlikte verilmelidir.


Prof. Dr. İsmail ÖRMAN
K.S.U. Tıp Fakültesi
K.B.B. A.D.
Dip. Tes. No: 131509 Uz. No: 3282


Doç. Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
KSÜ Tıp Fakültesi K.B.B. ABD
Dip. Tes. No: 117732