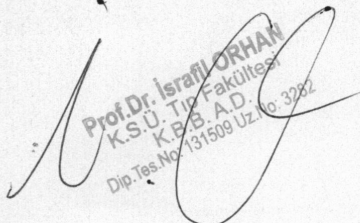
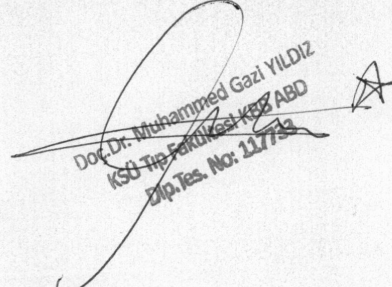


100

KULAK ASPIRATÖR UCU TEKNİK SARTNAMESİ

- 1- Steril paketlerde olmalıdır.
- 2- Çap uzunluklarını ve adetlerini kliniğimiz belirleyecektir.
- 3- Uzunluğu 80 mm olmalıdır.
- 4- Metal olmalıdır.
- 5- Sap kısmı plastik olmalı ve aspiratör hortumuna uygun olmalıdır.
- 6- Ürünler UTS'ye kayıtlı olmalıdır.


Prof. Dr. İsmail ORHAN
K.S.U. Tıp Fakültesi
K.B.B. A.D.
Dip. Tes. No: 131509 Uz. No: 3282


Dr. Dr. Muhammed Gazi YILDIZ
K.S.U. Tıp Fakültesi KBB ABD
Dip. Tes. No: 11775