


ÇELİK DOLAP 1500x550x1900mm
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolap 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap üzeri 2 bölmeli ve 4 kapaklı olmalıdır.
3. Dolap kapakları temizlik açısından çift cidarlı olmalıdır.
4. Dolap kapakları mıknatıslı sabitleyicilere sahip olmalıdır.
5. Her bir bölümde 3 adet ara raf olmalıdır.
6. Dolap altında iki sıra halinde toplam 3+3=6 adet çekmece olmalıdır.
7. Çekmeceler teleskopik raylı mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
9. Dolap boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
10. Dolap ölçüsü 1500 x 550 x 1900 mm(± 50 mm) olmalıdır.
11. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
12. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
13. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
14. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
15. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
16. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
17. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadi K. YILMAZ
Dış No: 177995
Uzmanlık No: 60082 Yandal No: 105121
K.S.U. Tıp Fakültesi Yeni Doğan Uzmanı

Selin AYTEMİZ
YDYB Ünltesi
Sorumlu Hemşire

Celik Dolap 1500 x 550 x 1500 mm

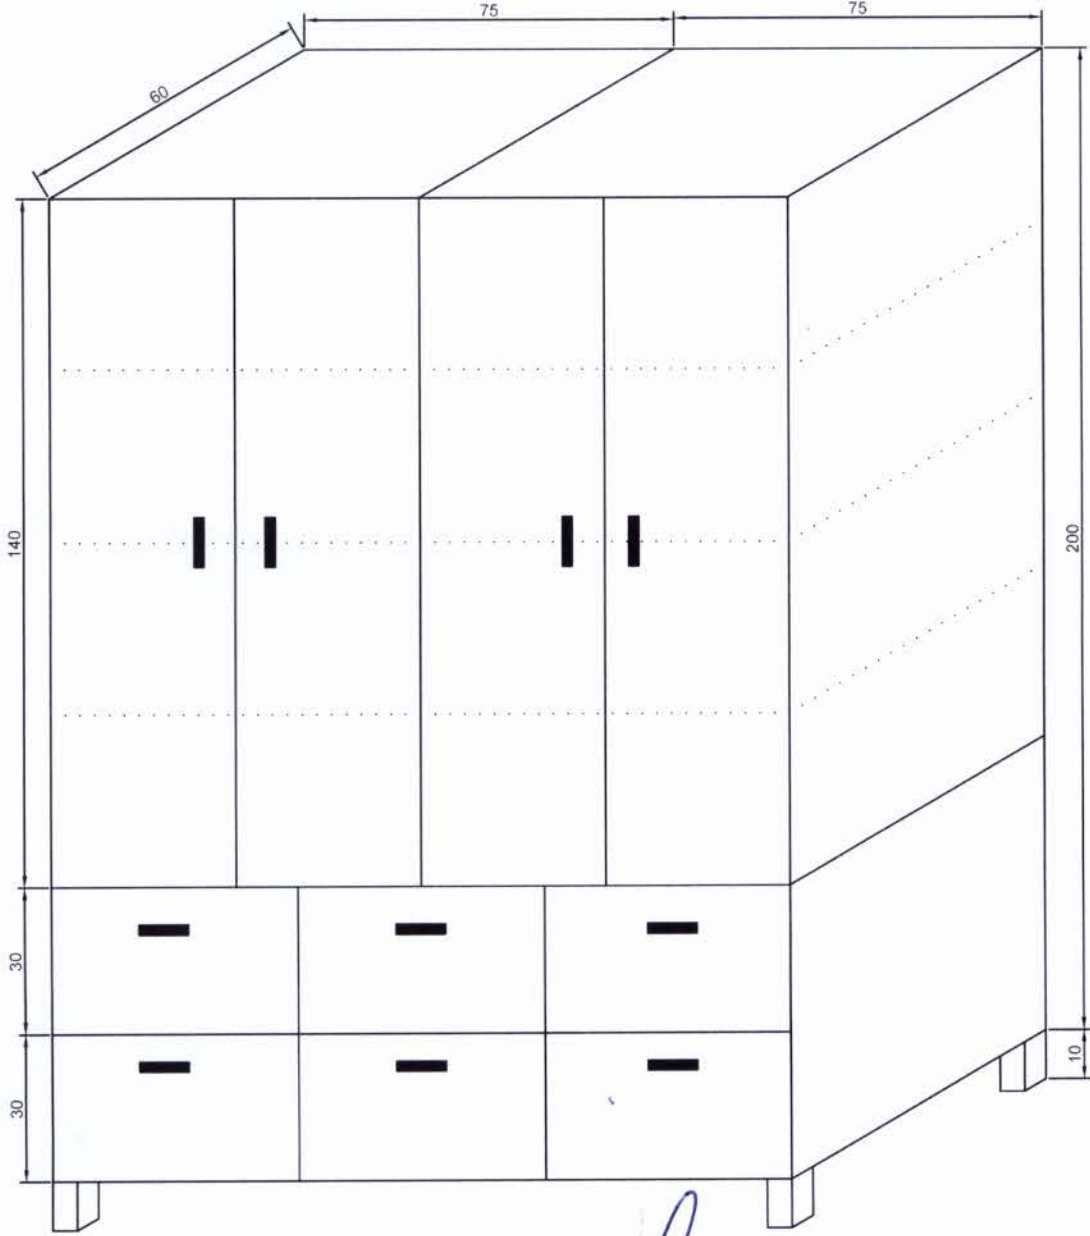

Doç. Dr. Sadık FURTTUTAN
Dipl. No: 117995
Uzmanlık No: 87002
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Tani Doğan Uzmanı

Selin AYTEMİZ
YDYA
Sorumlu Hemşire